




Prefeitura Municipal de Ipauimir
Governo Municipal
CNPJ nº 07.520.141/0001-84



**Junto aos autos as Propostas Consolidadas,
referentes ao Pregão Eletrônico nº 2022.03.09.1.**

Ipauimir/CE, 24 de março de 2022.


José Jonas Bezerra Leite
Pregoeiro Oficial do Município



MaisÉtica



Goiânia – GO, 24 de março de 2022


RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAUMIRIM
CNPJ: 07.520.141/0001-84
ENDEREÇO: Rua Coronel Gustavo Lima, 230, Centro
CEP: 63.340-000
RESPONSÁVEL: Comissão de licitações e contratos
EMAIL: licitacaoipaumirim2021@hotmail.com


CIDADE/UF: Ipaumirim – CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.09.1


PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI, CNPJ 29.795.338/0001-69, sediada à Rua AP-02, Nº 129, Quadra 05, Lote 15, Conjunto Aruanã III, Goiânia – GO, CEP 74.740-370, vem através deste encaminhar proposta de preços, conforme a seguir:

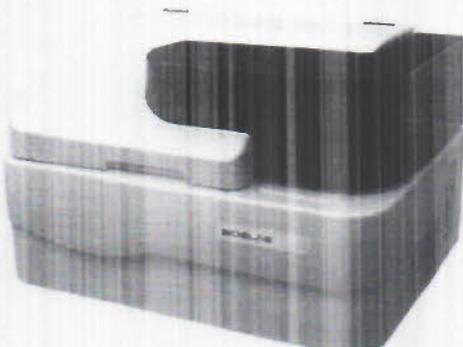ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QNT	VL UNT	VL TOTAL
01	<p>Analizador Bioquímico Automatico AS-120</p>  <p>Descrição Analizador Bioquímico Automatico AS-120</p> <p>120 testes / hora, reagente duplo - Acesso randômico. Totalmente automatizado.</p> <p>80 posições de reagentes, 40 posições de amostra 44 cuvetes de reação</p> <p>Sonda multifuncional de amostragem de alta precisão</p> <ul style="list-style-type: none">• Polimento de espelho externo e interno, lavagem de sonda externa e interna• Sonda de amostragem dedicada equipada com sensor de líquido sensível• Proteção de colisão, ajuste automático da profundidade da sonda	BIOELAB	UND	01	74.500,00	74.500,00



MaisÉtica

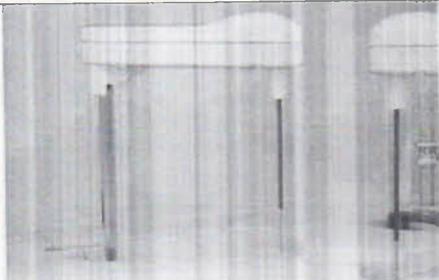


Excelente design de misturador

- Misturador de revestimento de teflon. Sem queda de água
- Excelente efeito de mistura com procedimento de mistura padrão




Bandeja de reagentes e bandeja de amostra

- 80 posições de reagentes, 40 posições de amostra
- Com interruptor separado, permitindo desligar o equipamento e manter a refrigeração dos reagentes ativa.
- Sistema de resfriamento ininterrupto com almofada peltier. 24 horas 2 °C -14 °C
- Leitor de código de barras (opcional) - Embutido internamente, acoplado ao rotor de amostras / reagentes.

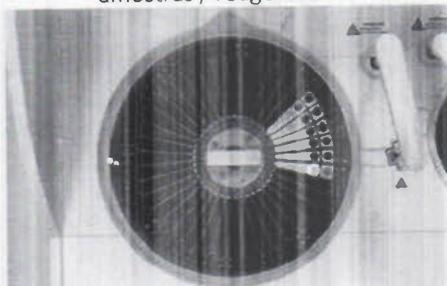


Bandeja de reação

- 44 cuvetes de reação
- Volume de reação tão baixo quanto 150µl
- Temperatura estável e precisa (37 ± 0,1 °C) para reação



Mais Ética

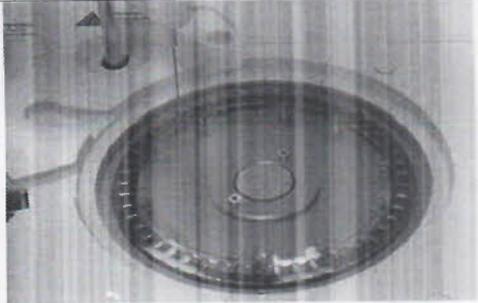

Software intuitivo e avançado

- Sistema Windows™ XP - 7 - 8 ou 10 em português.
- Interface de software amigável, simples e fácil de operar -
- Comunicação bidirecional. RS-232 - LAN Ethernet e USB.
- Diluição automática da amostra (diminuição, aumento, normal)
- Verificação automática do resultado da reação e calibração, alarme de advertência
- Calibração linear e não linear, calibração multipontos até 8 pontos
- O controle de qualidade aplica-se a westgard, gráfico LT, cumulativo
- Chaves Liga/Desliga separadas para refrigeração e equipamentos

INCLUSO NO VALOR DO EQUIPAMENTO:

- COMPUTADOR COM MOUSE, TECLADO, E MONITOR CONFIGURADO PARA UTILIZAÇÃO DO ANALISADOR
- INSTALAÇÃO E TREINAMENTO E TODOS OS ENCARGOS DA ENTREGA

MARCA: BIOELAB

MODELO: AS-120

REGISTRO ANVISA: 81492110023


PROCEDÊNCIA: CHINA

VALOR TOTAL: SETENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS.

74.500,00

- * Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;
- * Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias;
- * Forma de pagamento: 30 (trinta) dias;
- * Frete: CIF
- * Nos preços estão inclusas todas as despesas com frete, impostos, e todas as taxas para a perfeita entrega do material ao local designado pelo órgão;
- * Todos os produtos possuem seus devidos Registros junto à ANVISA, quando for obrigatório;

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, sob nenhuma hipótese.



MaisÉtica



Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do processo de compras da cotação prévia e convênio supracitado, que:

- a) Não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas;
- b) Declaramos inexistência de fatos impeditivos para contratar com o poder público, ou suspensão do direito de contratar com administração federal; declaração de inexistência de fatos impeditivos.
- c) Nos termos da Lei Federal nº. 6.544/89, nos encontramos em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
- d) Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no respectivo Edital;
- e) Dispostos, caso declarados homologados do objeto cotado, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado para a prestação dos serviços, com assistência técnica no local designado pelo órgão, no período de garantia solicitado no edital.
- f) Recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do edital.
- g) Nos comprometemos a substituir o equipamento entregue caso esteja fora da especificação da proposta.
- h) Garantimos que peças de reposição para os equipamentos estarão disponíveis pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos.

Qualquer dúvida entrar em contato. Fones: 062 3218 4079 / 3273 8258 ou e-mail vendas01@maisetica.com.br.

Atenciosamente,


MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 29.795.338/0001-69


29.795.338/0001-69
MAIS ÉTICA COMERCIAL EIRELI
Rua AP2 n° 129 Qd. 05 Lt. 15
Conjunto Residencial Aruanã III
CEP: 74.740-370
GOIÂNIA - GO

Jaqueline Carneiro de Mendonça Amorim
Diretora Administrativa
CPF 973.638.121-87
RG 3790847 DGPC - GO



ANALISADOR BIOQUÍMICO

Totalmente automatizado **AS-120**

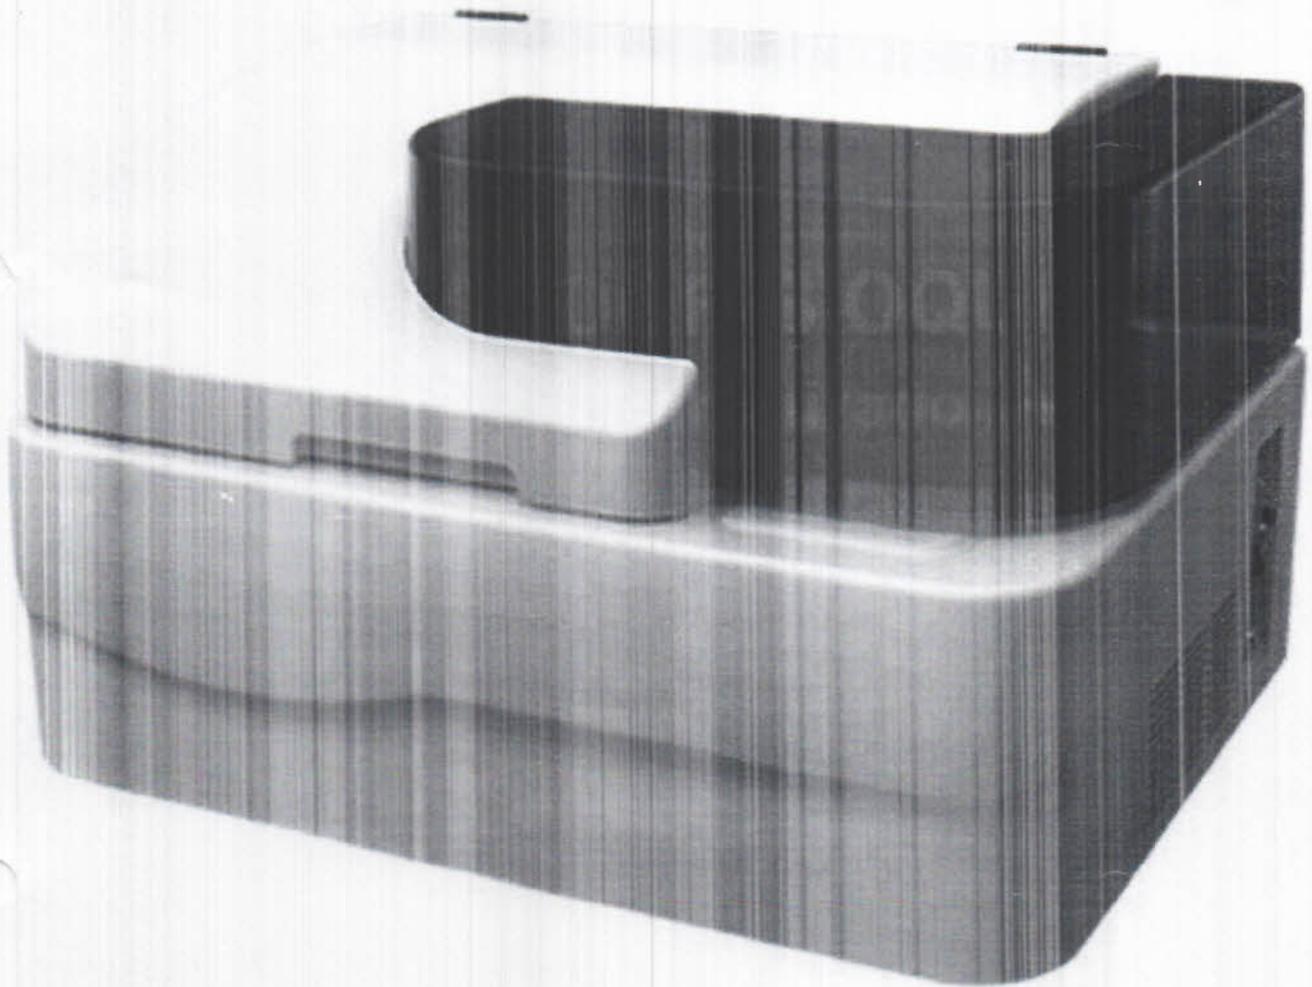

120 testes/hora
Reagente duplo

 **AmaMedical**
SOLUÇÕES EM SAÚDE

Av. Hilário Pereira de Souza, 406
Torre 2, 28º andar - Osasco/SP
Tel.: (11) 4384-2494 - (11) 4384-2454
vendas@amamedical.com.br



ANALISADOR BIOQUÍMICO

Totalmente automatizado AS-120



Desempenho	• 120 testes por hora/reagente duplo
Reagentes	• 80 posições para reagentes
Cubetas de Reação	• 44 cubetas reutilizáveis
Amostras	• 40 posições simultâneas
Módulo STAT	• Prioriza amostras de urgência
Código de Barras	• Leitor de código de barras opcional
Sistema Operacional	• Sistema Windows
Controle de Qualidade	• Levey Jennings, Gráficos X-R e Regras Múltiplas de Westgard.
Interfaceamento	• Comunicação bidirecional. • RS-232 - LAN Ethernet e USB.
Filtros	• 8 Filtros - Range de 340nm a 700nm
Método	• Bioquímica e Turbidimetria
Sensores	• Alarme sonoro e visual para agulhas, braços e reservatórios
Dimensões	• 57cm x 88cm x 52cm – 45kg
Alimentação	• AC-230V ou AC-110V



Av. Hilário Pereira de Souza, 406
Torre 2, 28º andar - Osasco/SP
Tel.: (11) 4384-2494 - (11) 4384-2454
vendas@amamedical.com.br



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	AMARAL & CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		
CNPJ	25.037.775/0001-62	Autorização	8.14.921-1
Produto	FAMÍLIA DE ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB		

Apresentação/Modelo

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - AS 160

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - AS 280

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - ES 200

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - AS 120

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - ES 380

ANALISADOR BIOQUÍMICO BIOELAB - ES 480

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	01-IFU BIOQUIMICO BIOELAB - MANUAL DO USUÁRIO REV 00.pdf	0520178/22-0 - 11/02/2022 - 04:07

Nome Técnico	Instrumento para análise de bioquímica geral, hormônios, drogas ou proteínas
Registro	81492110023
Processo	25351.711633/2019-14
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none"> FABRICANTE: E-LAB BIOLOGICAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - Classe II: produtos de médio risco ao indivíduo e ou baixo risco à saúde pública
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Three blue ink signatures are located in the bottom right corner of the page. They appear to be handwritten names or initials.



PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 2022.03.09.1

OBJETO: 1 A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades do Hospital Maternidade Maria José dos Santos, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Ipaumirim/CE, nos termos da proposta n. 12003.262000/1210-02 do Ministério da Saúde, conforme anexos, partes integrantes deste edital.

PROPONENTE: **VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI**

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epigrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

LOTE 2						
1	Homogeneizador: Características mínimas: Homogenizador de sangue para hematologia para uso em tubos de ensaio tipo Vacutainer. Com 1 controle de velocidade e gabinete fabricado em chapa de aço pintura em Epoxi. Capacidade: 20 Tubos. Alimentação elétrica a ser definida ! pela entidade solicitant	SEVENLABOR/SVN-38	UND	1	R\$ 1.420,00	R\$ 1.420,00
	Pipetador Automático: Tipo aid com filtro	KASVI	UND	1	R\$1.450,00	R\$1.450,00
3	Banho-Maria: Capacidade que atenda de 90 a 105 tubos. Temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas. Capacidade entre 6,6 litros a 10 litros. Tampa em 3 aço inox ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. Estante única para tubos de ensaio. Controlador	KACIL/BM03	UND	1	R\$2.220,00	R\$2.220,00

Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli – CNPJ 10.485.989/0001-24 – Av Jose Rodrigues Alves nº 11 Jardim Adalgisa – Cajazeiras CEP: 58.900-000 - PB Fone / Fax: (83) 3531-2515



	de temperatura com display. Faixa de trabalho, no mínimo, entre -100 C e 1200 C, com precisão igualou melhor Que + 1,50°C					
4	Cronômetro: Tipo e progressivo reorressivo	JKNEW/ET2061	UND	1	R\$48,00	R\$48,00
5	Estetoscópio Adulto: Material de confecção do auscultador/tipo, aço inoxidável/duplo	PREMIUM	UNID	2	R\$307,00	R\$614,00
TOTAL						R\$5.752,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$5.752,00 (cinco mil setecentos e cinquenta e dois reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

CAJAZEIRAS-PB, 24 DE MARÇO DE 2022.

Vescia Maria Fernandes Duarte

VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI
CNPJ:10.485.989/0001-24
VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE
CPF n° 721.201.004-97
RG n° 1155971 - SESPDS - RN
DIRETOR

Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli – CNPJ 10.485.989/0001-24 – Av Jose Rodrigues Alves nº 11 Jardim Adalgisa
– Cajazeiras CEP: 58.900-000 - PB Fone / Fax: (83) 3531-2515